TINENG

ГРУНТ

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА УСАДКУ SS-1

Для определения влажности усадки после потери образцом влаги, линейной усадки, объёмной усадки и коэффициента усадки.

Соотношение рабочей площади пористой пластины и отверстий	Менее 2:1
Микрометр	Ø10 мм×4 мм
Режущее кольцо	Ø61,8 мм×20 мм
Площадь образца	30 см2×2 см
Размеры	110×105×125 мм
Вес	1 кг

ГРУНТОВОЙ АРЕОМЕТР 22-T0062/A

СТАНДАРТ: BS 1377

Ареометры для грунта служат для определения гранулометрического состава мелкозернистых грунтов в ареометрическом анализе. Длинная колба. 0,995–1,030 г/мл.

ПРИБОР ДЛЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PSA-5000

СТАНДАРТ: ASTM D422, AASHTO T88, UNE 103.102

Для определения гранулометрического состава очень мелких материалов, таких как ил и глина. Испытание проводится на оборудовании, которое можно выбирать отдельными приборами или полным комплектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
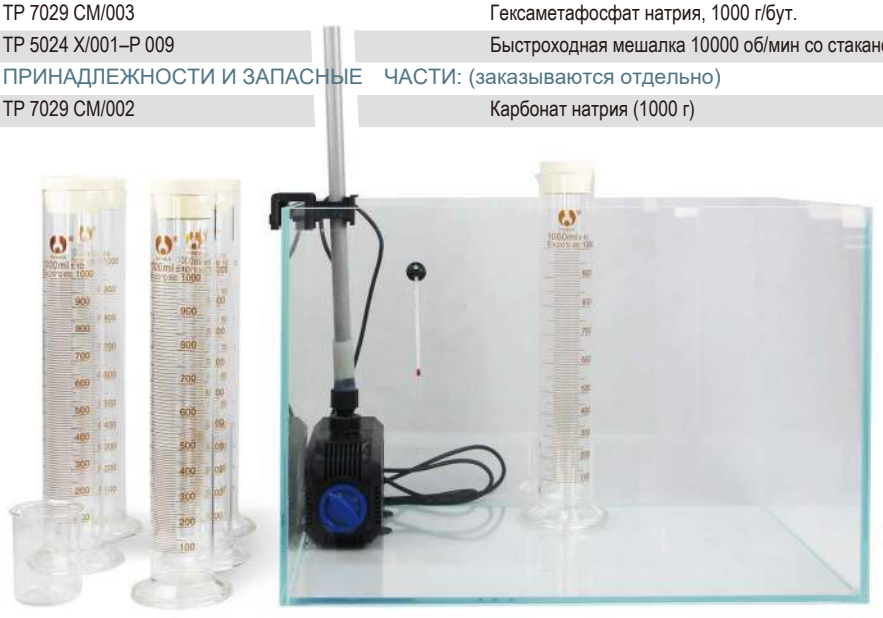
TP 5024 X/001–P 001	Водяная баня с нагревателем и циркуляционным насосом 240 В, 1 ф, 50/60 Гц	1 шт.
TP 5024 X/001–P 002	Стакан для ареометра 1000 мл	6 шт.
TP 5024 X/001–P 003	Резиновая пробка для стакана ареометра	6 шт.
TP 7010 G/001	Грунтовой ареометр с длинной колбой 151H, 0,995–1,038 г/мл	1 шт.
TP 7034 X/018	Стеклянный термометр 0–50 °C × 0,5 °C	1 шт.
TP 7002 G/004	Стеклянный стакан с носиком 250 мл	1 шт.
TP 7029 CM/003	Гексаметафосфат натрия, 1000 г/бут.	1 бут.
TP 5024 X/001–P 009	Быстроходная мешалка 10000 об/мин со стаканом и отражателем 240 В, 1 ф, 50/60 Гц	1 шт.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: (заказываются отдельно)		
TP 7029 CM/002	Карбонат натрия (1000 г)