TINPENG


SYD-0653
جهاز اختبار شحنة الجسيمات

نظرة عامة على المنتج

طُوّر جهاز اختبار الشحنة الأيونية لجسيمات الأسفلت المستحلب وفق طريقة T0653-2025 لاختبار الشحنة الأيونية لجسيمات الأسفلت المستحلب، الواردة في JTG 3410-2025. ويُستخدم لتحديد قطبية الأيونات ونوع شحنة جسيمات الأسفلت المستحلب.

المكونات الرئيسية

يتكون النظام من سلك تغذية، وأقطاب من الفولاذ المقاوم للصدأ، ووحدة رئيسية قابلة للضبط، وشاشة لعرض الجهد والتيار والزمن، وكابلات توصيل الأقطاب، ومشابك تمساح، وكأس سعة 250 مل.

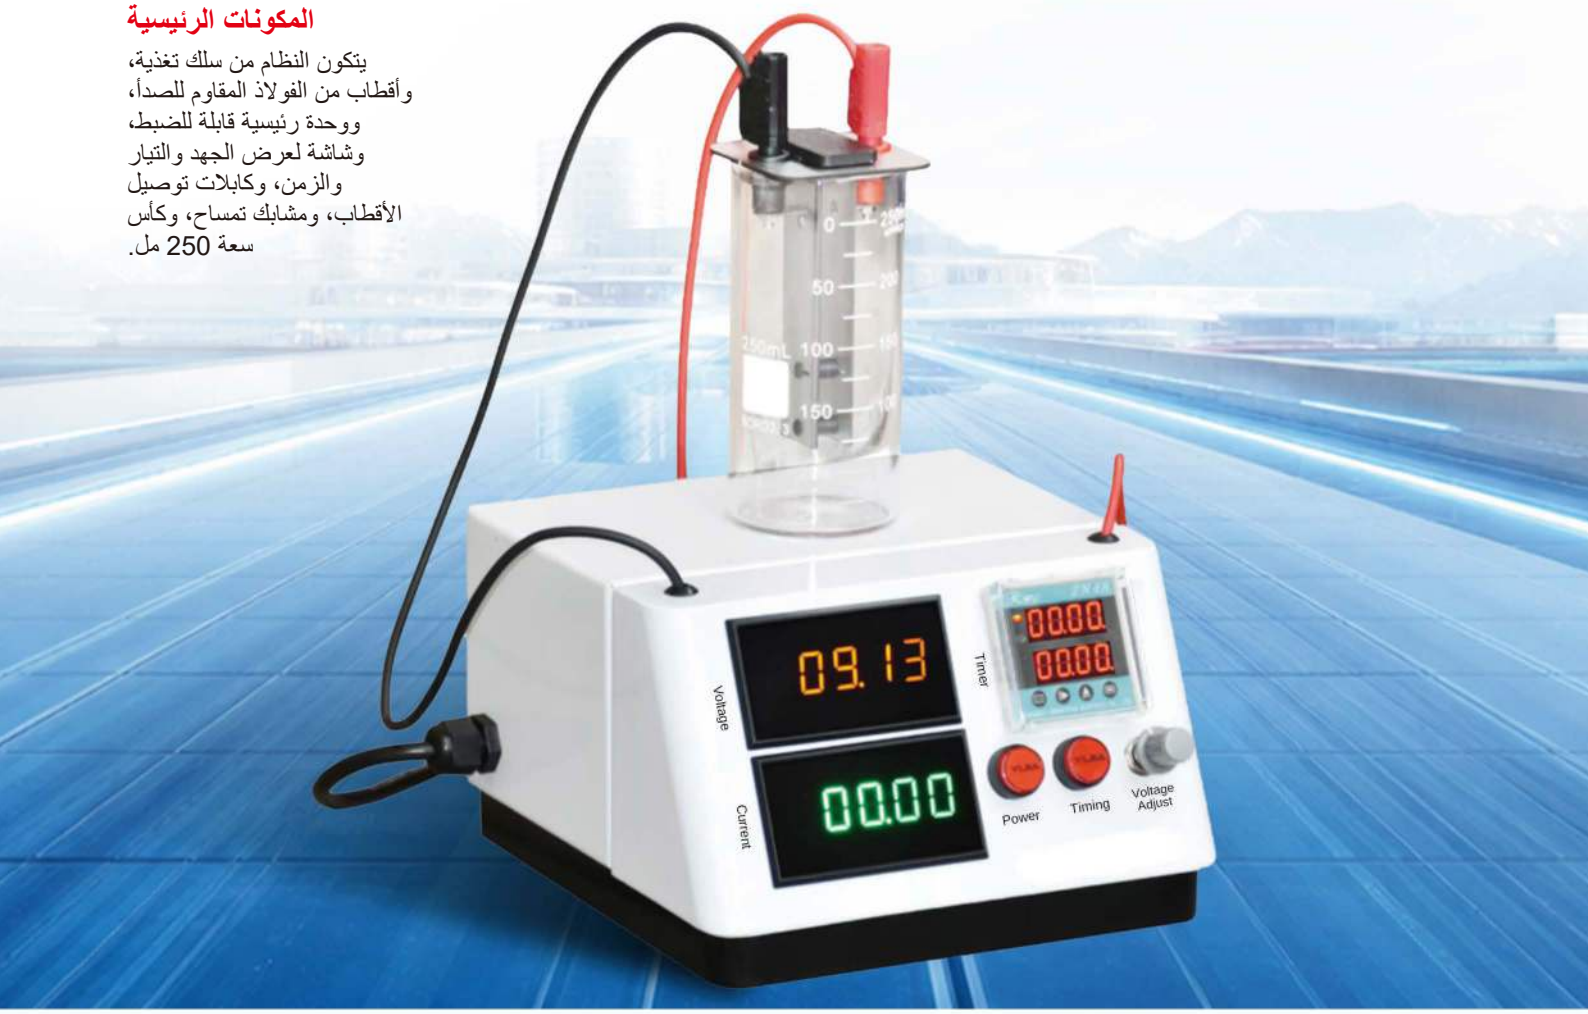

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة / القيمة
جهد التغذية	220 فولت
أقصى تيار خرج	150 ملي أمبير
دقة المؤقت	1 ثانية
مدى ضبط المؤقت	0–999 ثانية
جهد الخرج المستمر	قابل للضبط من 0 إلى 36 فولت؛ مقاومة متغيرة مدمجة توفر تيارًا مستمرًا لا يقل عن 50 ملي أمبير
الأقطاب	قطبان من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ طول كل منهما 100±1 مم، وعرضه 25±1 مم، وسُمكه نحو 1 مم؛ المسافة المتوازية بينهما 12±2 مم؛ علامة تدريج على بُعد 25±1 مم من أسفل القطب
حامل الأقطاب	ارتفاع قابل للضبط مع تثبيت تلقائي
الكأس	سعة 250 مل
القدرة	200 واط
درجة الحرارة المحيطة	5–40 °م
الرطوبة المحيطة	≤85%

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880